

คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้า

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เพื่อการตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัดและการรักษาทั่วไป

๒. ลักษณะทั่วไป

๒.๑ เป็นเตียงสำหรับตรวจประเมินและรักษาทางกายภาพบำบัด สามารถปรับสูง-ต่ำได้โดยใช้ระบบไฟฟ้า

๒.๒ ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ เป็นเตียงแบบ ๒ ตอนสำหรับทำหัตถการ ปฏิบัติการตรวจรักษา

๓.๒ เตียงสามารถปรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เซนติเมตร และสามารถปรับได้ต่ำสุดไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรโดยวัดจากพื้นห้องถึงพื้นเตียง

๓.๓ เตียงมีขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๒๐๐ เซนติเมตร

๓.๔ ตัวเตียงส่วนรองรับศีรษะและหลังยาวไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร พร้อมช่องสำหรับหายใจขณะเมื่อทำการตรวจประเมินในท่านอนคว่ำสามารถปรับมุมขึ้นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ องศา

๓.๕ ส่วนรองรับลำตัวและขายาวไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร

๓.๖ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๓.๗ เบาะทำด้วยหนังเทียม มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร

๓.๘ สามารถปรับสูง-ต่ำของเตียงโดยใช้แป้นเหยียบ (Foot Switch)


๓.๙ สามารถเคลื่อนย้ายได้มีล้ออย่างน้อย ๔ ล้อ

๓.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑ หรือเทียบเท่า

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑ สายไฟต่อเข้าเตียงแบบมีกราวด์ จำนวน ๑ เส้น

๔.๒ มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด

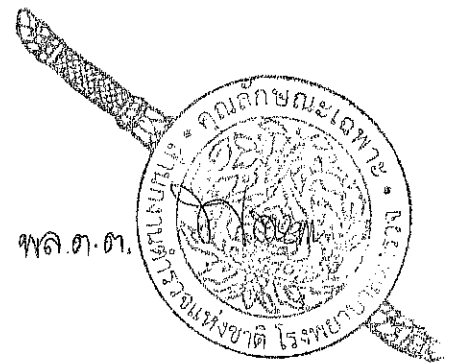

พ.ต.อ.หญิง.....ประธานกรรมการ พ.ต.ท.....กรรมการ ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ
(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล) (สุพจน์ พุ่มพฤษ) (อรอนงค์ อุทัย)

๕.การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจพินิจความเรียบร้อย ตามข้อ ๒.,๓. และ๔.

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖.ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพ พร้อมทั้งความชำรุดบกพร่อง ตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมบริการให้ตลอดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖.๒ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจสอบและออกใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่อง(Maintenance) ทุก๑ ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

๖.๓ ผู้ขายจะต้องจัดการอบรมการใช้เตียงปรับระดับด้วยไฟฟ้าให้กับเจ้าหน้าที่ของทางราชการจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงจนกว่าจะใช้งานได้

พ.ต.อ.หญิง.....๒๖๖๖.....ประธานกรรมการ

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

นายแพทย์(สบ๕)หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พ.ต.ท.....กรรมการ


(สุพจน์ พุ่มพฤษย์)

นักรายภาพบำบัด(สบ๓) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ร.ต.อ.หญิง.....กรรมการ

(อรอนงค์ อุทัย)

นักรายภาพบำบัด(สบ๑) กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

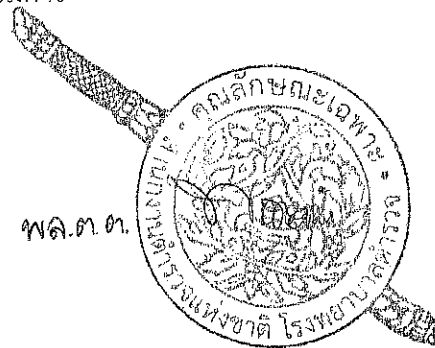

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

เห็นชอบ

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘

พ.ต.อ.หญิง.....๒๖๖๖.....ประธานกรรมการ

พล.ต.ต.

(กัตติกา ภูมิพิทักษ์กุล)

(พรชัย ไทยแท้)

นายแพทย์(สบ๕)หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขาธิการคณะกรรมการพิจารณาคณะลักษณะเฉพาะฯ