

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับทำผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง

๒.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ประกอบด้วย

๓.๑.๑ คีมจับเนื้อเยื่อชนิด THOMS-ALLIS ความยาว ๘ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ คีมจับหนีบเส้นเลือดชนิด OCHSNER-KOCHER ปลายตรง ความยาว ๗ นิ้ว

จำนวน ๑ กล่อง

๓.๑.๓ ที่ถ่างแผล Abdominal Retractors ขนาด ๔๕ x ๘๐ มม.

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๔ กรรไกรตัดสายสะดือชนิด MOD.USA ความยาว ๔ ๑/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๕ ขามรูปไต ๒ นิ้ว

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๖ ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๗ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยวิธีนึ่ง อบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

จำนวน ๑ อัน

๓.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

จำนวน ๑ กล่อง

๓.๒.๑ ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒.๒ ด้านบนของฝาและด้านล่างของกล่อง มีรูระบายอากาศเรียงตัวเป็นแนวตรง

๓.๒.๓ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ มม.

๓.๒.๔ มีฝาปิดแยกออกจากกันได้ และมีที่ล็อกแน่นด้านข้างของตัวกล่อง

๓.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕


๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑ สเปรย์สำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ ชนิดทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส

จำนวน ๑ กระป๋อง

๔.๒ แผ่น Paper Label

จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

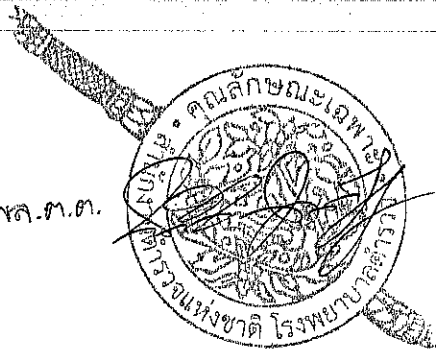

พ.ต.อ.หญิง..... ประธาน พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ

(กรทอง การพานิช)

(จิราภรณ์ พันภัย)

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔


๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา ๕ ปี

๖.๒ มีการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือนพร้อมมีเอกสารแสดงการตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของชุดเครื่องมือนี้ทุกครั้ง

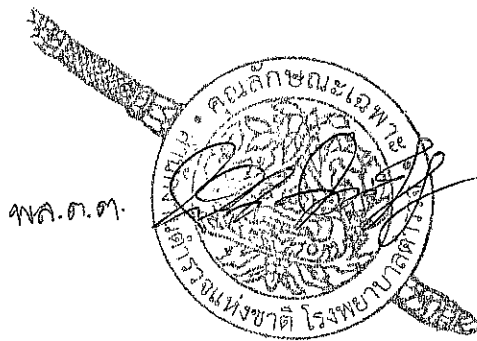

พ.ต.อ.ต.ต.

เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี อธิพงษ์)

นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ดร.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน

(กรทอง การพานิช)

พยาบาล (สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ดร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(จิราภรณ์ พันภัย)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ดร.

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ดร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

พ.ล.ต.ต.

(ชรินทร์ สุดโนรีกุล)

ผบก.อก.รพ.ดร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ดร.