

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดมดลูก

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับทำผ่าตัดชุดมดลูก

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดมดลูก

๒.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดมดลูก ประกอบด้วย

๓.๑.๑	คีมจับผ้าก๊อซและสำลีชนิด FOERSTER ปลายตรง ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๒	คีมจับผ้าก๊อซและสำลีชนิด FOERSTER ปลายโค้ง ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๒ อัน
๓.๑.๓	คีมจับเนื้อเยื่อแบบมีเขี้ยว ๕x๖ ชนิด ALLIS ความยาว ๗ ๑/๒ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๔	คีมจับมดลูกชนิด SCHROEDER ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๕	เครื่องมือหยั่งความลึกโพรงมดลูกชนิด SIMS ความยาว ๑๒ ๑/๒ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๖	คีมจับหนีบมดลูกชนิด BOZEMANN แบบ S-curved ความยาว ๑๐ ๑/๔ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๗	คีมจับผ้าก๊อซและสำลีชนิด BERGMANN-FOERSTER ความยาว ๒๔ ซม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๘	คีมจับผ้าก๊อซและสำลีชนิด FLETCHER(JAVERTS) ความยาว ๒๔ ซม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๙	ท่อสวนปัสสาวะสำหรับผู้หญิงชนิด GUYON ขนาด ๑๔ เฟรนซ์	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๐	ปากคืบเนื้อเยื่อแบบไม่มีเขี้ยว ความยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๑	ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด SIMS ขนาด ๗๐ x ๓๐/๓๕ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๒	ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด JACKSON ขนาด ๙๐ x ๔๐ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๓	ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด KRISTELLER ขนาด ๗๐ x ๒๗ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๔	ที่ถ่างปากช่องคลอดชนิด PEDERSON ขนาด ๑๐๐ x ๒๒ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๕	เครื่องมือสำหรับขยายปากมดลูกชนิด HEGAR ขนาด ๓/๔ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๖	เครื่องมือสำหรับขยายปากมดลูกชนิด HEGAR ขนาด ๕/๖ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๗	เครื่องมือสำหรับขยายปากมดลูกชนิด HEGAR ขนาด ๗/๘ มม.	จำนวน ๑ อัน
๓.๑.๑๘	เครื่องมือสำหรับขยายปากมดลูกชนิด HEGAR ขนาด ๙/๑๐ มม.	จำนวน ๑ อัน

พล.ต.ต.




จำนวน ๑ ชุด

จำนวน ๑ กล่อง

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ
(กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี พรศิริรัตน์)

๓.๑.๑๙	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๐๐	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๐	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๐	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๑	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๑	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๒	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๒	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๓	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๓	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๔	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๔	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๕	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๕	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๖	ที่ชุดมดลูกชนิด RECAMIER เบอร์ ๖	จำนวน	๑ อัน
๓.๑.๒๗	ชามรูปไต ๑๐ นิ้ว	จำนวน	๑ ใบ
๓.๑.๒๘	ถ้วยไอโอดีน ๖ ออนซ์	จำนวน	๑ ใบ
๓.๑.๒๙	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)		
๓.๑.๓๐	สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยวิธีหนึ่ง อบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค		
๓.๒	กล่องบรรจุเครื่องมือ	จำนวน	๑ กล่อง
๓.๒.๑	ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)		
๓.๒.๒	ด้านบนของฝาและด้านล่างของกล่อง มีระบายอากาศเรียงตัวเป็นแนวตรง		
๓.๒.๓	ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ มม.		
๓.๒.๔	มีฝาปิดแยกออกจากกันได้ และมีที่ล็อคแน่นด้านข้างของตัวกล่อง		
๓.๓	ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕		
๔.	ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่		
๔.๑	สเปรย์สำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ ชนิดทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส	จำนวน	๑ กระป๋อง
๔.๒	แผ่น Paper Label	จำนวน	๑๐๐ ชิ้น
๕.	การทดสอบและผล		
๕.๑	ตรวจพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔		
๕.๒	ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้ดี		

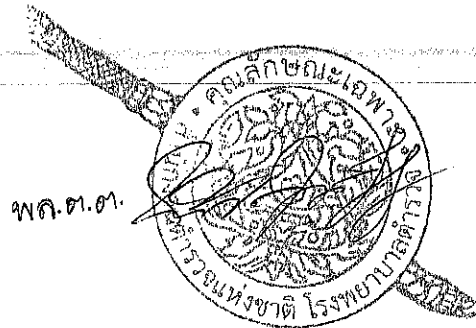

พ.ต.อ.หญิง..... ประธาน พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ
 (กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี่ พรศิริรัตน์)

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อมให้บริการตลอดระยะเวลา ๕ ปี

๖.๒ มีการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือนพร้อมมีเอกสารแสดงการตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของชุดเครื่องมือนี้ทุกครั้ง

เห็นชอบ

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน

(กรทอง การพานิช)

พยาบาล (สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.อ.

(เสรี อีรพงษ์)

นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(จิราภรณ์ พันภัย)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร. พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙

พล.ต.ต.



(ชรินทร์ สุตโนริกุล)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ



พล.ต.ท.