

คุณลักษณะเฉพาะ
ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งนรีเวช

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับทำผ่าตัดมะเร็งนรีเวช

๒. ลักษณะทั่วไป

ประกอบด้วย

๒.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งนรีเวช

๒.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ

๓. คุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการ

๓.๑ ชุดเครื่องมือผ่าตัดมะเร็งนรีเวช ประกอบด้วย

๓.๑.๑ คีมจับเส้นเลือดชนิด MIXTER ปลายโค้ง ความยาว ๙ นิ้ว

จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด MAYO-HEGAR ความยาว ๙ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๑ กล่อง

๓.๑.๓ คีมจับเข็มเย็บแผลชนิด MAYO-HEGAR แบบปลายปากบาง (Delicate Pattern)
ความยาว ๑๐ ๑/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๔ ปากคีมจับเส้นเลือดชนิด DE BAKEY ขนาด ๒ มม. ความยาว ๘ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๕ ปากคีมเนื้อเยื่อชนิด RUSS.MODELL ความยาว ๘ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๖ ปากคีมเนื้อเยื่อชนิด RUSS.MODELL ความยาว ๙ ๓/๔ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๗ คลิปหนีบเส้นเลือดชนิด JOHNS HOPKINS ความยาว ๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๘ คลิปหนีบเส้นเลือดชนิด JOHNS HOPKINS ความยาว ๓ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๙ ที่ถ่างแผลชนิด CUSHING ขนาด ๑๒ มม. ความยาว ๙ ๑/๒ นิ้ว

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๐ ที่ถ่างแผลชนิด LOVE ชนิดตรง

จำนวน ๒ อัน

๓.๑.๑๑ เข็มโค้งแบบ Ligature ชนิด DESCHAMPS ปลายมนสำหรับมือขวา

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑๒ เข็มโค้งแบบ Ligature ชนิด DESCHAMPS ปลายมนสำหรับมือซ้าย

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑๓ เข็มแบบ Ligature ชนิด SCHAMIEDEN-PAYR ความยาว ๗ ๑/๒ นิ้ว หรือ ๑๙ cm.

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑๔ เข็มแทงนาร่องขนาด ๑๐ charr./Fr.

จำนวน ๑ อัน

๓.๑.๑๕ ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (stainless steel)

๓.๑.๑๖ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยวิธีหนึ่ง อบแก๊ส หรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๓.๒ กล่องบรรจุเครื่องมือ


จำนวน ๑ กล่อง

๓.๒.๑ ทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม (Stainless Steel)

๓.๒.๒ ด้านบนของฝาและด้านล่างของกล่อง มีรูระบายอากาศเรียงตัวเป็นแนวตรง

๓.๒.๓ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๓๖๐ มม. กว้างไม่น้อยกว่า ๒๖๐ มม. สูงไม่น้อยกว่า ๙๐ มม.

๓.๒.๔ มีฝาปิดแยกออกจากกันได้ และมีที่ล็อกแน่นด้านข้างของตัวกล่อง

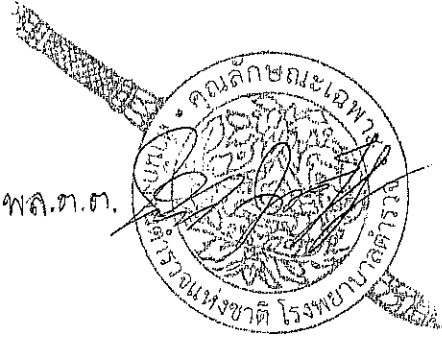

พ.ต.อ.หญิง..... ประธาน พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ พ.ต.ท.หญิง..... กรรมการ
(กรทอง การพานิช) (จิราภรณ์ พันภัย) (สุนทรี พรศิริรัตน์)

๓.๓ ได้รับการรับรองมาตรฐาน EC Certificate และ EN ISO ๑๓๔๘๕

๔. ส่วนประกอบและอุปกรณ์อะไหล่

๔.๑ สเปร์ยสำหรับหล่อลื่นเครื่องมือ ชนิดทนความร้อนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส

จำนวน ๑ กระป๋อง

๔.๒ แผ่น Paper Label

จำนวน ๑๐๐ ชิ้น

๕. การทดสอบและผล

๕.๑ ตรวจสอบพินิจความเรียบร้อยตามข้อ ๒,๓ และ ๔

๕.๒ ทำการทดสอบจนสามารถใช้งานได้

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพพร้อมความชำรุดบกพร่องตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา ๒ ปี และจะต้องมีอะไหล่ไว้พร้อม ให้บริการตลอดระยะเวลา ๕ ปี


๖.๒ มีการบรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๖.๓ ในระหว่างรับประกันผู้ขายจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก ๖ เดือนพร้อมมีเอกสารแสดงการ ตรวจสอบและแจ้งผลการบำรุงรักษาให้กับหน่วยงานเจ้าของชุดเครื่องมือนี้ทุกครั้ง

ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ รพ.ตร.

ได้มีมติเห็นชอบตามคุณลักษณะเฉพาะฯ ที่เสนอในคราวประชุม

ครั้งที่ ๑๙/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๙

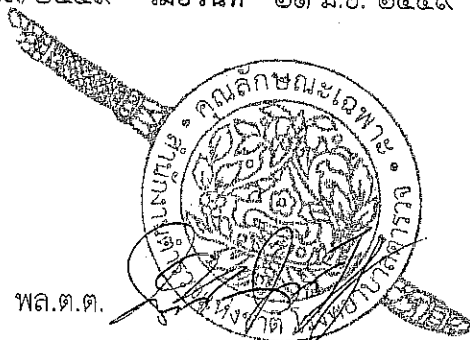

พล.ต.ต.

(ชรินทร์ สุตโนริกุล)

ผบก.อก.รพ.ตร. /

เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะฯ
เห็นชอบ

พ.ต.อ.

(เสรี ธีรพงษ์)

นายแพทย์ (สบ๕) กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ตร.

พ.ต.อ.หญิง.....ประธาน

(กรทอง การพานิช)

พยาบาล (สบ๕) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(จิราภรณ์ พันภัย)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.

พ.ต.ท.หญิง.....กรรมการ

(สุนทรี พรศิริรัตน์)

พยาบาล (สบ๓) กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตร.